



韦睿APD自动腹膜透析机操作手册


(1) 启动机器及处方设置

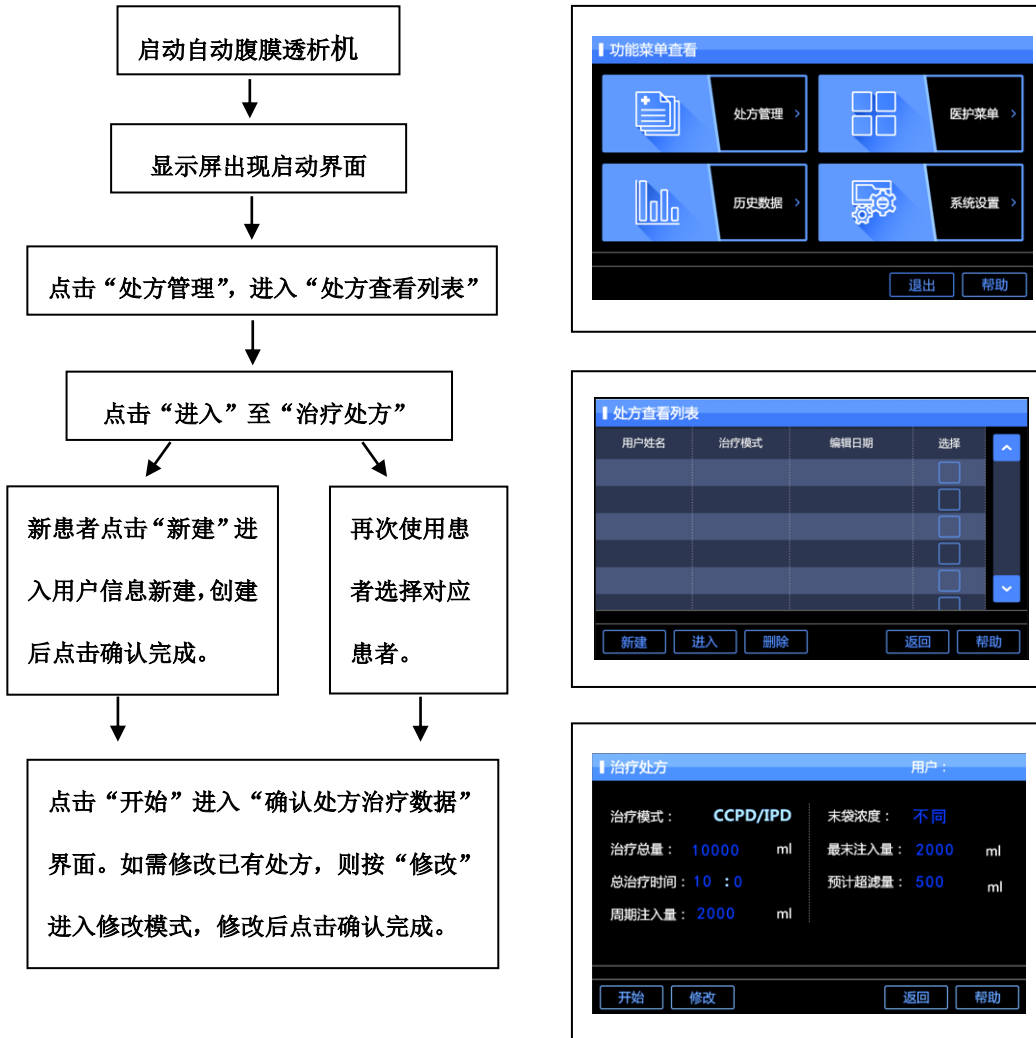


(2) 装置管路

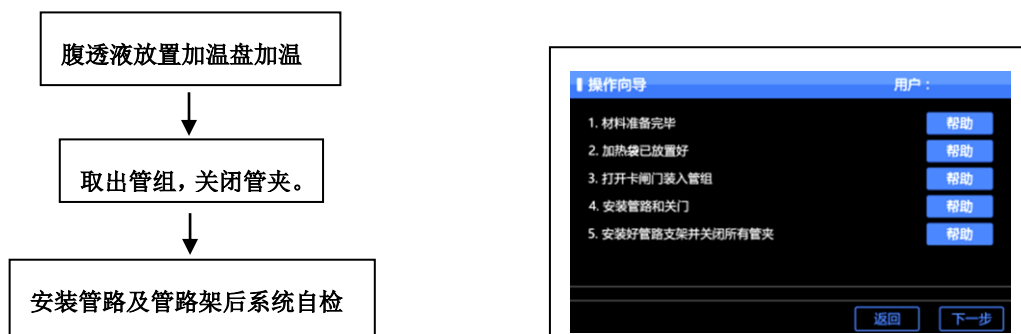


(3) 连接透析液及排气

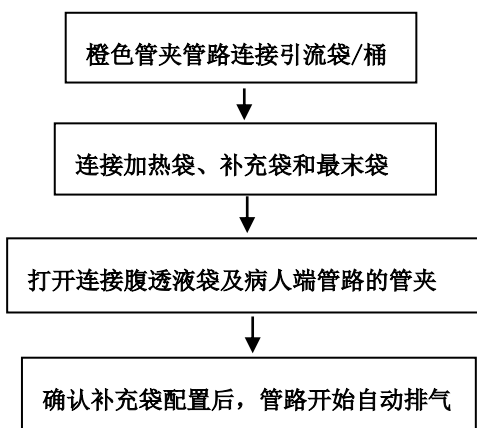

(4) 连接病人端管路

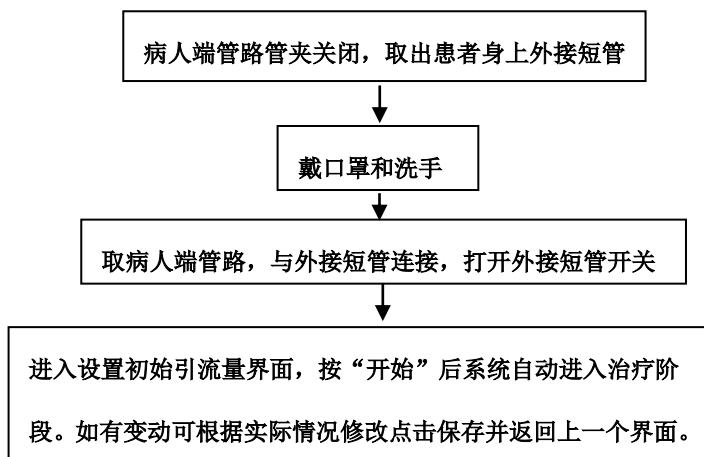

(5) 结束治疗

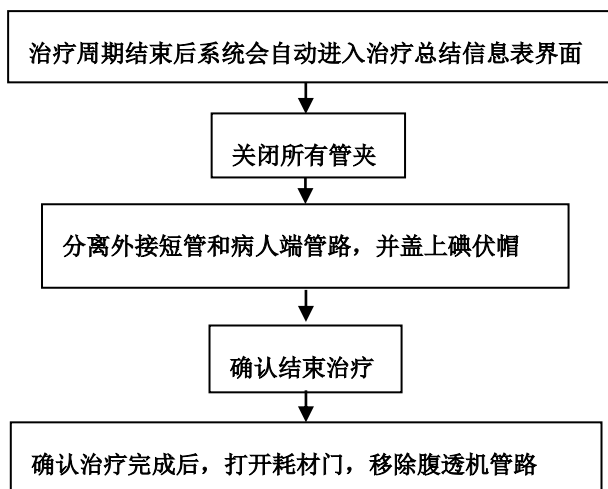

	注入	引流	超滤量	滞留时间
初次引流量	—	ml	—	—
周期：	ml	ml	ml	
周期：	ml	ml	ml	
周期：	ml	ml	ml	
周期：	ml	ml	ml	
最末注入量	ml	—	—	—
总计	ml	ml	ml	

Buttons: 手动引流 (Manual Drainage), 结束治疗 (End Treatment)

